




# Монитор пациента РМ-600 (HUAO, YCC, SpO2)

атчик

156020611 PROD. No 5120 SN  
 MRF009 N6BD86301-00A  
 N6BD86425-30A (+ теор.)



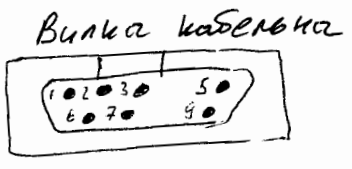


Темно 0mV  
 Визуал. 292mV } Червон  
 Темно 0mV  
 Визуал. 328mV } ИК

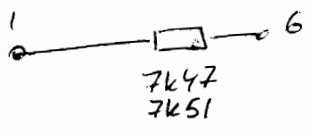

Погоджувач

425940611  
 MXC009

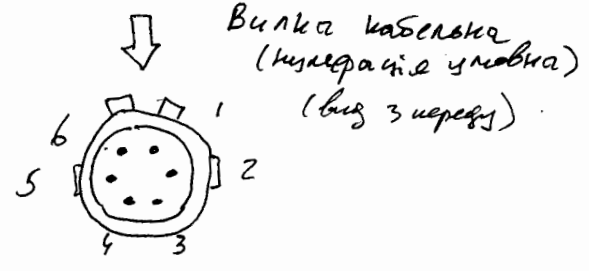
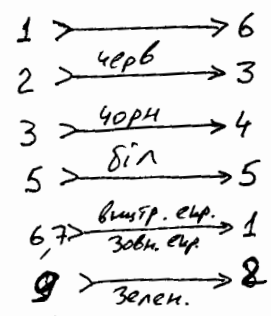
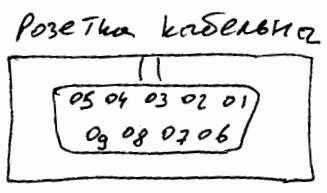


Вилка кабельна (інтеграція члвнн)  
 (виз з червн)

Плата SpO2

9005-20-08531 V.C

Розетка блоку (виз з червн)

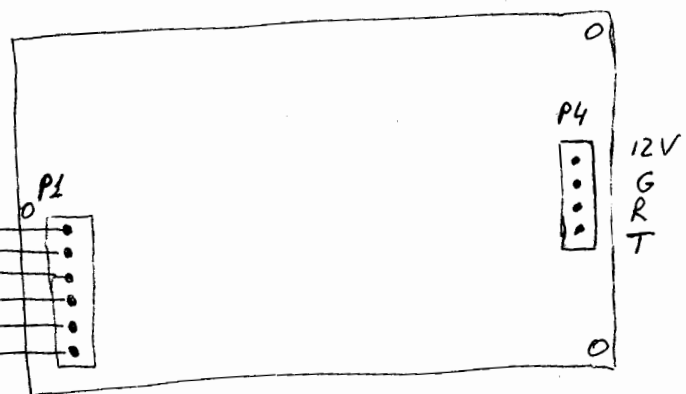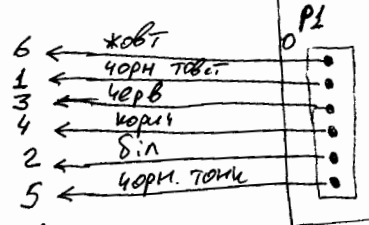

Вона не використовується

Акумулятор 6MD-1,3 -  $I_{зар} = 13V$

РГ1Н-1-3 та РЛ2Н-1-18

$I_{зар} = 140mA$

$I_{разр} = 350-550mA$