
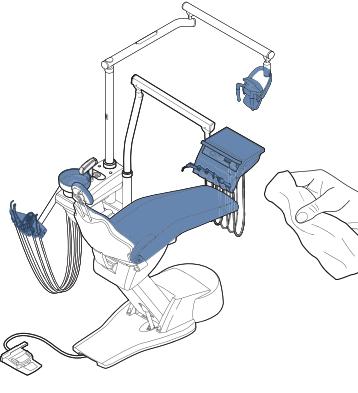

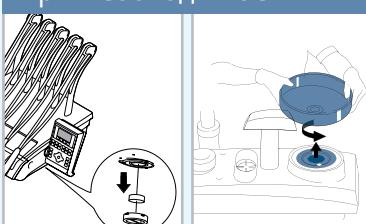


## План ухода и чистки

Когда?	Что?	Как?
<b>По утрам</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Промывка шлангов инструментов (внутри) и водопроводящих систем</li> <li>■ Промывка всасывающих шлангов (внутри) и системы отсоса</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Промывайте все места отбора в течение 2 минут</li> <li>▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды</li> </ul>
<b>После каждой процедуры лечения</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Промывка шлангов инструментов (внутри) и водопроводящих систем</li> <li>■ Промывка всасывающих шлангов (внутри) и системы отсоса</li> <li>■ Очистка и дезинфекция <ul style="list-style-type: none"> <li>- Всасывающих шлангов (снаружи) и шлангов инструментов (снаружи)</li> <li>- Плевательницы и ситечка</li> <li>- Поверхностей приборов, мягкой обивки и лампы</li> </ul> </li> <li>■ Очистка и дезинфекция <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ручек на модуле врача и стоматологической лампы KaVoLUX 540 LED</li> <li>- Ручек стоматологических ламп EDI и MAIA</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Промывайте все места отбора в течение 20 секунд</li> <li>▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды.</li> <li>▶ При необходимости дезинфекции: проведите отсос дозы геля DEKASEPTOL из дозатора</li> <li>▶ Очистите вручную и дезинфицируйте протиранием</li> </ul>
<b>По вечерам</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Промывка шлангов инструментов (внутри) и водопроводящих систем</li> <li>■ Вставок-ситечек</li> <li>■ Очистка и дезинфекция <ul style="list-style-type: none"> <li>- Всасывающих шлангов (внутри)</li> <li>- Системы отсоса</li> <li>- Плевательницы</li> </ul> </li> <li>■ Всасывающих шлангов (снаружи) и шлангов инструментов (снаружи)</li> <li>■ Соединительных элементов для всасывающих шлангов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Промывайте все места отбора в течение 20 секунд</li> <li>▶ Осмотрите и, при необходимости, замените</li> <li>▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды.</li> <li>▶ При необходимости дезинфекции: проведите отсос дозы геля DEKASEPTOL, уложите шланги</li> <li>▶ Положите дозу геля DEKASEPTOL в плевательницу и почистите ее щеткой</li> <li>▶ Очистите вручную и дезинфицируйте протиранием</li> <li>▶ Снимите наконечники ① и ② и проведите их термодезинфекцию, наконечники ③ и ④ продезинфицируйте протиранием</li> </ul>
<b>Каждую пятницу</b> и после длительного простоя		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Очистка и дезинфекция <ul style="list-style-type: none"> <li>- шлангов инструментов (внутри)</li> <li>- водопроводящих систем</li> <li>- всасывающих шлангов снаружи</li> <li>- системы отсоса</li> <li>- плевательницы</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проведите интенсивную ручную стерилизацию.</li> <li>▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды.</li> <li>▶ При необходимости дезинфекции: проведите отсос дозы геля DEKASEPTOL из дозатора</li> <li>▶ Положите дозу геля DEKASEPTOL в плевательницу и почистите щеткой</li> </ul>
<b>При необходимости</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Рециркуляционного фильтра турбины</li> <li>■ Коврика для укладки инструментов/ противоскользящего коврика</li> <li>■ Опоры стакана для полоскания</li> <li>■ Подставки для инструментов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Осмотрите, при необходимости замените и очистите выпуск фильтра</li> <li>▶ Снимите и подверните термодезинфекции</li> <li>▶ Снимите, очистите вручную и проведите дезинфекцию протиранием</li> <li>▶ Снимите, очистите вручную и проведите дезинфекцию протиранием</li> </ul>
<b>ОСТОРОЖНО</b>	<p><b>Используйте только те средства дезинфекции, которые были одобрены компанией KaVo!</b></p> <p>План ухода и чистки касается только самых необходимых эксплуатационных функций. Он не является заменой поставляемому с оборудованием руководству по эксплуатации, которого следует придерживаться во избежание неисправностей и аварийных случаев.</p>	
	<p><b>Разрешенные дезинфицирующие средства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikrozid Liquid (фирма Schülke &amp; Mayr)</li> <li>- FD 322 (фирма Dürr)</li> <li>- Incidin Liquid (фирма Ecolab)</li> <li>- CaviCide (фирма Metrex)</li> </ul>	
	 <p><b>KaVo. Dental Excellence.</b></p>	