

РИСУНОК А


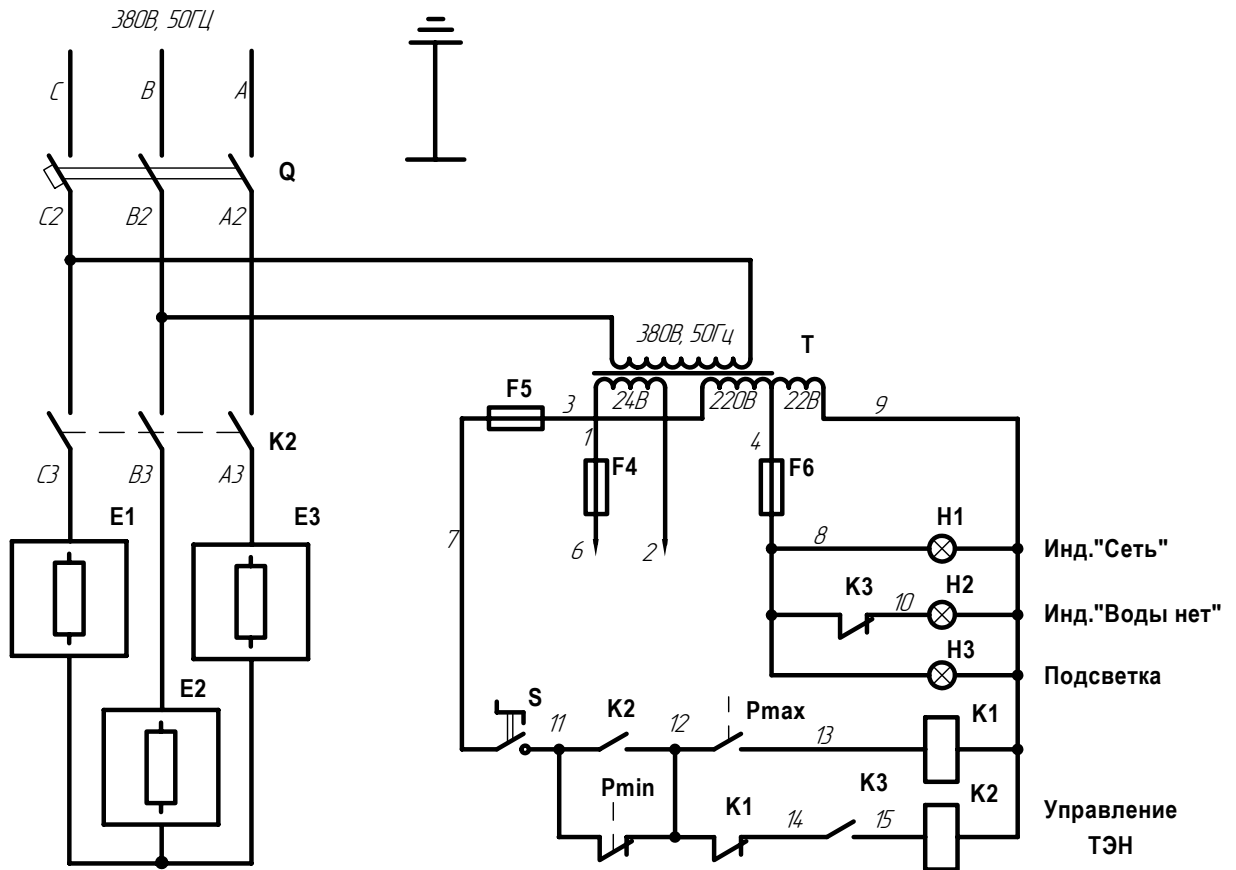


РИСУНОК Б
(остальное см. рисунок А)

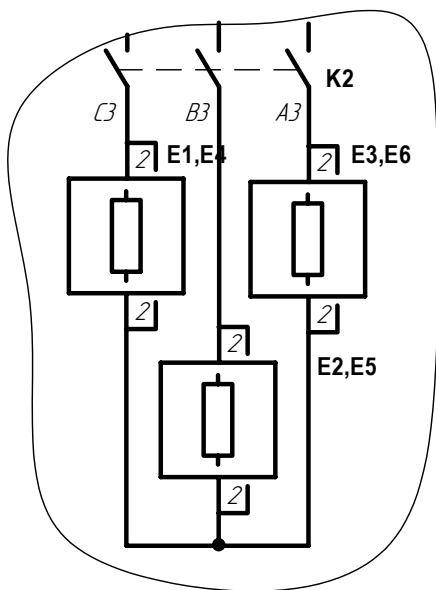

Допускается вместо ТЭН152.03.000 – 3 шт. (рис. А) устанавливать
ТЭН78.02.000-10 – 6 шт. (рис. Б).

РИСУНОК 3 - Стерилизатор паровой ГК-100-3
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ